



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 318923
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1068693


Заказчик Акционерное общество "Озенмунайгаз"
Организатор Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	395-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Динамограф
Дополнительная характеристика	Значение: КОМПЛЕКС ЭХОЛОТ+ДИНАМОГРАФ МИКОН 101
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Комплекс динамограф + эхолот Микон 101М Программно-аппаратный комплекс предназначен для определения уровня жидкости и измерения величины давления в затрубном пространстве нефтяных скважин, а также для исследования работы скважин с глубинными штанговыми насосами методом динамометрирования с целью контроля работы насосного оборудования, получение динамограммы работы ШГН. Данный товар закупается для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта основного (установленного) оборудования. Комплекс состоит из аппаратной и программной частей. Функции • Определение уровня. • Снятие динамограммы, контроль работы клапанов. • Оперативное отображение эхограммы и динамограммы на графическом экране блока регистрации. • Автоматическая регистрация даты и времени замера. • Сохранение замеров в энергонезависимой памяти блока регистрации. • Просмотр сохраненных замеров. • Перенос сохраненных замеров на ПК. Основные технические характеристики Диапазон определяемых уровней УПАС-22П м 50...4000 Диапазон измерения давления УПАС-22 МПа 0...10 Предел приведенной погрешности измерения давления % 1 Присоединительная резьба УПАС-22П 2" (НКТ60) Диапазон измерения нагрузки кгс 0...10000 Диапазон измерения положения м 0...5 Предел допускаемой приведенной основной погрешности измерений нагрузки ДВ-118 % 1 Предел допускаемой приведенной основной погрешности измерений нагрузки ДН-117 % 5 Предел приведенной погрешности измерения перемещения % 5 Количество замеров, без эхограмм, сохраняемых в энергонезависимой памяти БР 6000 Количество эхограмм (длительностью 10 секунд), сохраняемых в БР 70 Количество циклов динамограмм, сохраняемых в энергонезависимой памяти БР 256 Количество таблиц скоростей распространения акустических сигналов 1 Количество таблиц коэффициентов усиления 1 Продолжительность непрерывной работы (без подогрева дисплея) час 8 Рабочий диапазон температур БР без подогрева дисплея °С -20...+50 Рабочий диапазон температур БР с подогревом дисплея °С -35...+50 Рабочий диапазон температур остальных элементов системы °С -0...+50 Комплектность: Наименование Кол-во Примечание Блок регистрации (БР) 1 Поставляется упакованным в чехол МК-101.19.00.0.00 с установленными аккумуляторами Динамометр накладной (ДН) 1 Устройства приема акустических сигналов УПАС-22 1 Предназначена для измерения уровня при давлениях от 0 до 100кгс/см² Клапан 1 Устройство генерации акустических сигналов УГАС-25 1 Кабель БР-ДН117/ДН118 1 Кабель БР21-ПК USB 1 Кабель БР21-УПАС 1 Кейс 1 Программное обеспечение 1 На компакт-диске. Допускается замена программы на новые версии Микрофон с кольцом уплотнительным 1 Программа «Менеджер измерений» 1 Поставляется по специальному заказу Устройство зарядное 1 Допускается замена без согласования с заказчиком Кольцо уплотнительное 028-033-30 1 Только для УПАС Кольцо уплотнительное 054-060-36 1 Только для УПАС Кольцо уплотнительное 060-065-30 1 Только для УПАС Аккумулятор Поставляется по специальному заказу Руководство по эксплуатации 1 Формуляр 1 Руководство пользователя к программе 1 Руководство пользователя к программе «Менеджер измерений» 1 Свидетельство о проверке 1 Паспорт 1 Методика проверки 1 Обязательные требования: Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать наименования страны происхождения и завода изготовителя предлагаемого товара. Потенциальный поставщик до момента вскрытия заявок должен представить Заказчику образец программного аппаратного комплекса с комплектующими приборами по адресу: Республика Казахстан, г.Жанаозен, улица Сатпаева 3, 4 этаж, 402 каб. Поставляемый прибор должен быть занесен в реестр «Государственная система измерений» (ГСИ) РК. Поставщик вместе с товаром должен представить документ (сертификат) о прохождении первичной поверки и сертификат об утверждении типа

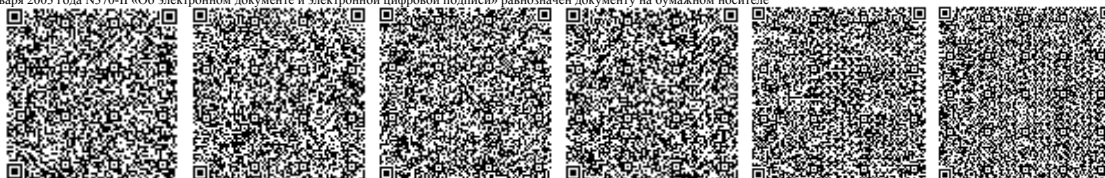



«Средств измерений» (СИ). Поставщик должен обеспечить обучение персонала заказчика с работой, эксплуатацией данного оборудования. График поставки: 60 дней с момента подписания договора. Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки. Поставка продукции производится по адресу: АО «Озенмұнайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТОиКО, код получателя 3118, Казахстан ТемирЖолы, код станции 663908, код ОКПО 05752590.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю

осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта

Подписал
Дата подписания

ӘБІШАЕВ ҚУАНЫШБЕК МҰХТАРҰЛЫ
08.08.2019

